

医療用品(03) 手術用手袋及び指サック  
一般医療機器 歯科用手袋 JMDN70911000

## VIP GLOVE ニトリルタイプ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・この製品は合成ゴムを使用しています。合成ゴムはかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血液低下、ショックなどのアレルギー性症状をまねに起こすことがあります。このような症状を起こした場合は、直ちに使用を中止し医師に相談のこと。(\*)
- ・合成ゴムによるアナフィラキシー様症状の経験がある医療従事者の使用及び患者への使用禁止。(\*)
- ・この製品は歯科用デスポーザブル製品なので再使用禁止。


#### 【形状・構造及び原理等】 (\*\*)

形状：左右兼用型歯科用グローブ(\*)

型式：XS、S、M、L(\*)

構造：グローブの寸法・計測部位

厚さ (A)・(B)・幅 (C)・全長 (D)

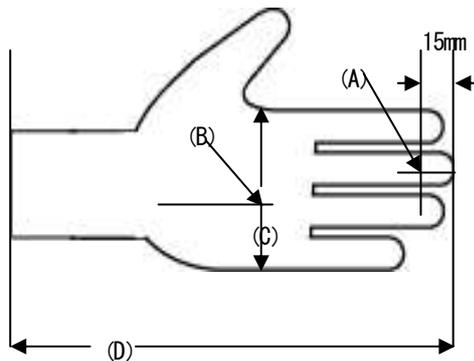

| サイズ | 各部の基準値(寸法/mm) |            |       |        |
|-----|---------------|------------|-------|--------|
|     | A(厚さ) 中指      | B(厚さ) 掌部中央 | C(幅)  | D(全長)  |
| XS  | 0.08 以上       | 0.08 以上    | 76±4  | 230 以上 |
| S   | 0.08 以上       | 0.08 以上    | 86±4  | 230 以上 |
| M   | 0.08 以上       | 0.08 以上    | 98±4  | 230 以上 |
| L   | 0.08 以上       | 0.08 以上    | 107±4 | 230 以上 |

- ・主材料：合成ゴム(\*)
- ・左右兼用、未滅菌タイプ(\*)
- ・表面性状：細かい梨地状、パウダーフリー(\*)

使い捨て歯科用ゴム手袋: JIS T 9113:2000 による

| 試験項目 |            | 性能     |
|------|------------|--------|
| 老化前  | 引っ張り強さ MPa | 15 以上  |
|      | 切断時伸び %    | 500 以上 |
| 老化後  | 引っ張り強さ MPa | 11 以上  |
|      | 切断時伸び %    | 450 以上 |

- ・原理：手の形状に合わせて作られた合成ゴム製の手袋で、手に被せることで歯科の診察、治療及び処置時に感染及び汚れ等から守るために使用する。(\*)

#### 【使用目的又は効果】 (\*\*)

- ・本製品は歯科の診察、治療及び処置に用いるゴム製又はビニール製の手袋をいう。手術用に用いるものを除く。(\*)

#### 【使用方法等】 (\*\*)

- ・最小包装単位包装から手袋を取り出す。(\*)
- ・手に装着する。(\*)
- ・使用は1回限りで破棄すること。(\*)

#### 【使用上の注意】 (\*\*)

- ・本製品は、刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますので注意すること。
- ・本製品は未滅菌です。
- ・使用前にピンホール、破れが無いことを確認の上、使用すること。
- ・合成ゴムによるアレルギーの既往歴のある方は使用しないこと。(\*)
- ・本製品はデスポーザブルタイプですので、感染防止のため患者ごとに新しいものに取り替えること。

#### 【保管方法及び有効期間等】 (\*\*)

- ・品質保持のため、高温・多湿・直射日光のあたる場所は避けて、保管してください。
- ・使用期間：製造年月より3年間(個装箱に記載)  
(自己認証による)
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 (\*\*)

製造販売業者  
株式会社日本歯科商社  
製造業者  
ハータレガ社(マレーシア)  
(英名) Hartalega Sdn. Bhd